Istruzioni per eseguire il controllo di qualità esterno (CQE) con l'apparecchio Cobas h 232®

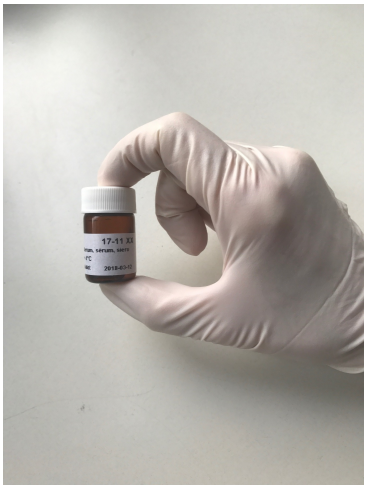

Il campione di controllo (CA o DD) per il Cobas h 232® è costituito da un flacone di siero pronto all'uso.

Prima del suo utilizzo, portare il campione a temperatura ambiente (20 – 25 °C, 20 minuti circa).

Assicurarsi che il Cobas h 232® sia pronto al dosaggio.

Selezionare il menù "test paziente".

Identificare il campione di CQE.

Mescolare accuratamente il contenuto del flacone con 10-15 movimenti rotatori.

Prelevare dal frigorifero una striscia-test e introdurla immediatamente nell'apparecchio → La fase di riscaldamento della striscia-test avviene nel Cobas h 232® (appare il simbolo del termometro).

A partire dal segnale acustico, prelevare con precisione 150 µL di campione (assicurarsi dell'assenza di bolle d'aria nel puntale).

Depositare tutto il volume prelevato sulla parte prevista a quest'effetto della striscia-test.

Cominciare il dosaggio premendo su "✓".

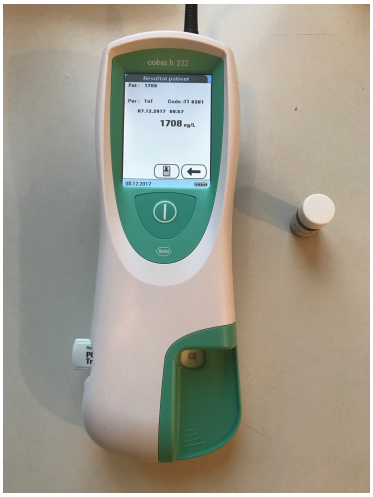

Il risultato del dosaggio appare allo schermo e viene salvato nella memoria automaticamente.

Bisogna dare un risultato quantitativo con il campione di CQE.

Esempio

- Risultato letto sullo schermo: « **negativo (< 40 ng/L) »**
- Risultato da acquisire: « **< 40 ng/L »**

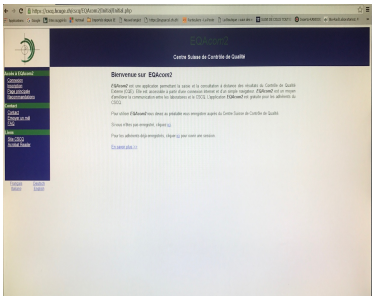

Durante l'acquisizione in EQAcom, scegliere nel menù a tendina l'unità utilizzata dall'apparecchio.

Cliccare su "Trasmetti al CSCQ".

Per coloro che danno ancora i risultati compilando il formulario dei risultati, correggere se necessario l'unità stampata.

Dopo aver realizzato tutte queste tappe, conservare il falcone di CQE in frigorifero (4 – 8 °C) fino al momento della ricezione del rapporto. In caso di valutazione insufficiente, è possibile rifare il dosaggio per controllare.

Alcuni punti importanti da rispettare

- **Non toccare la striscia-test prima della visualizzazione del risultato sullo schermo.**
- **Non spostare l'apparecchio durante il dosaggio.**
- **Per selezionare l'unità del suo apparecchio, vedere il suo manuale dell'utente.**